

Porovnání systémů pro výrobu mastí

ZL /Centrální laboratoř/ Eschborn, Rosemarie Eifler-Bollen

PZ /Pharm.Zeitung/ roč. 143, č. 38, 17.9.98 str. 53-65

Tabulka 6 str. 62


Betamethasonová mast 0,05%

Třenka - Fa, systém Tubag - Tu, systém Unguator - UN

Výroba podle předpisu

Odběr vzorku 6x50mg: Fa různá místa, Tu z tuby ve stejnoměrných odstupech, UN nahoře, ve středu, dole, boční úsek 2x, oblast víčka

	třenka	systém Tubag	UNGUATOR
lékárna 1	9,9		2,8
lékárna 2	8,6	8,1	2,8
centr. lab.	3,6	4,2	3,1
průměr	7,4	6,2	2,9

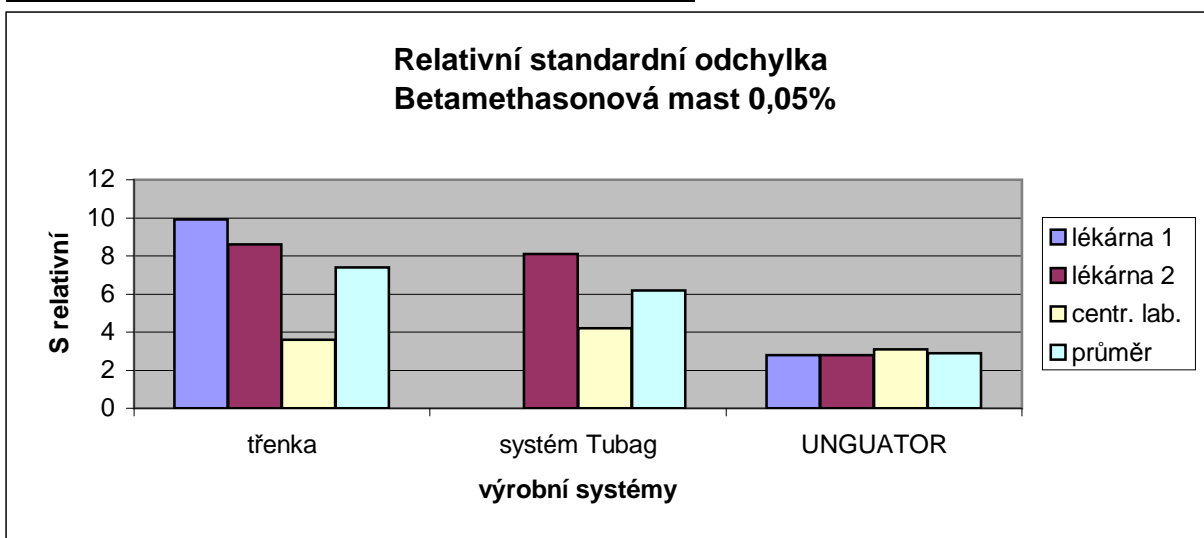

Bez tabulky str. 62

Salicylová vazelína 10%

Metoda s použitím grindometru

Třenka - Fa, systém Tubag - Tu, systém Unguator - UN

<nm

třenka	systém Tubag	UNGUATOR
100	90	80

